


فرایند خارج کردن لوله تراشه در بیمارستان امام علی (ع)

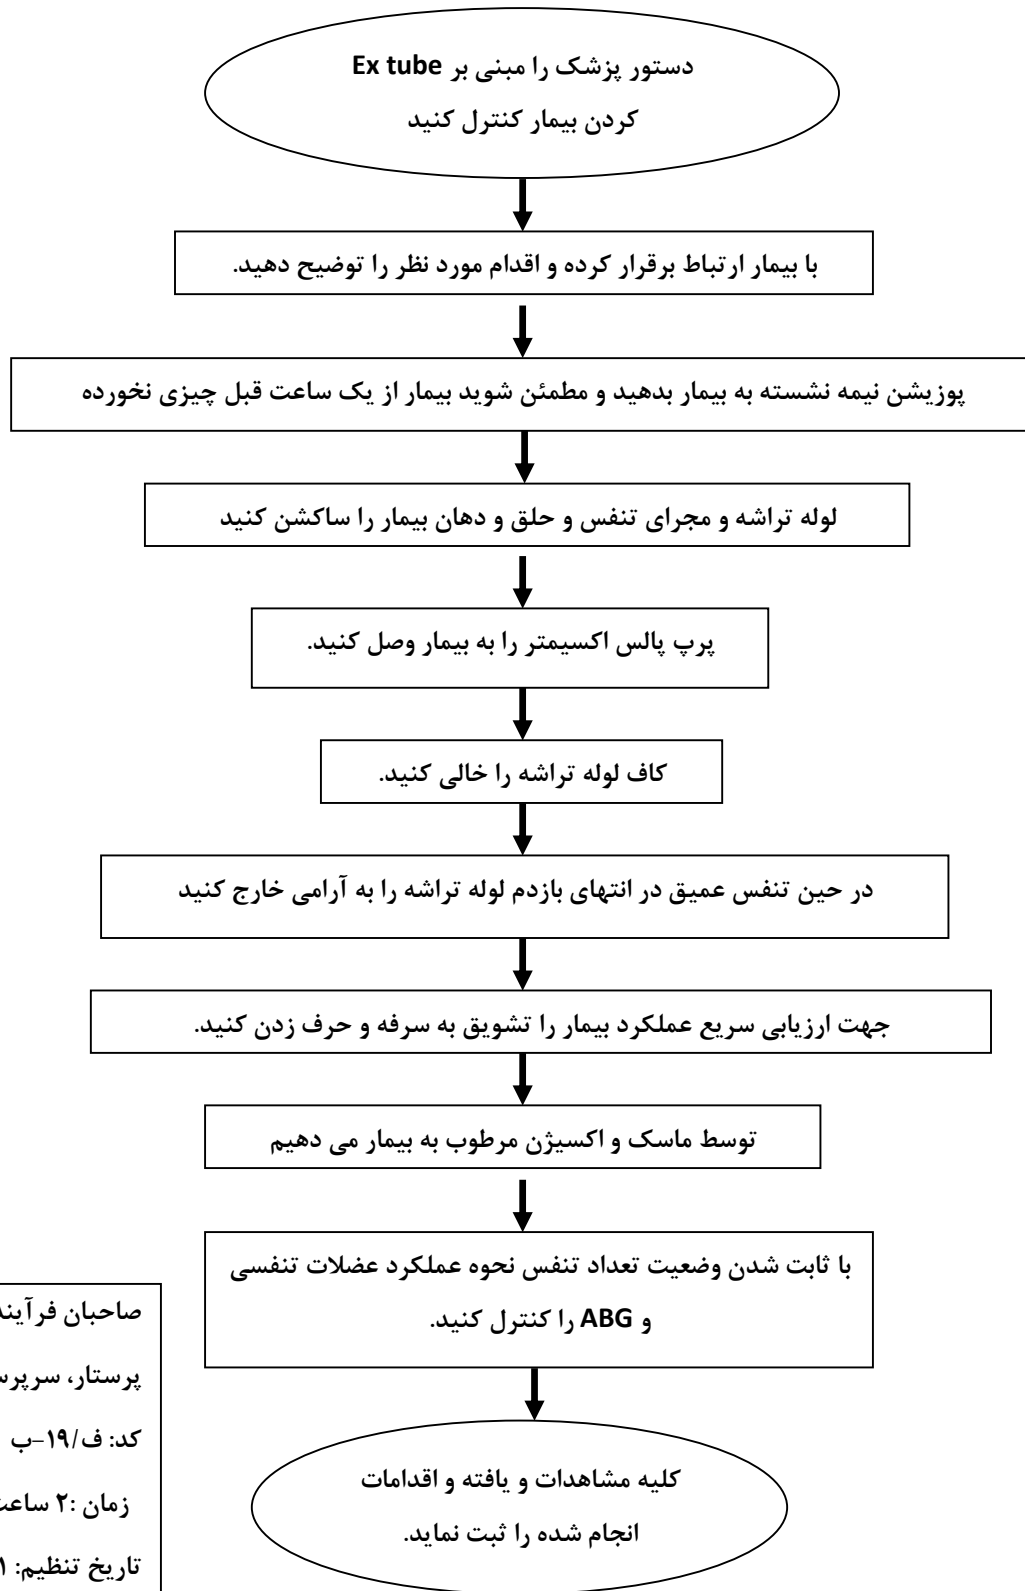

صاحبان فرآیند:

پرستار، سرپرستار، پزشک

کد: ف/۱۹-ب

زمان: ۲ ساعت

تاریخ تنظیم: ۹۱/۱۲/۱

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۴/۱۲/۱

چک لیست تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای فرایند خارج کردن لوله تراشه

- سال

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	عنوان
												برگ دستور پزشکی و پرونده بیمار
												پالس اکسی متر
												پروپ پالس اکسی متر
												ساکشن
												کنتر ساکشن
												نرمال سالین
												قیچی تمیز
												سرنگ
												دستکش تمیز
												ماسک اکسیژن
												کنتر اکسیژن
												هپارین
												سرنگ انسولین
												آیس بگ
												سیستم his جهت درخواست آزمایش
												لوازم التحریر
												ماسک یکبار مصرف برای پرستار

مسئول بخش:

امضاء: